


HPLC Reprot

采集人 :huo  
 样品名称 :RM24182  
 色谱柱 :Diamonsil 5um C18(2) 4.6\*150mm  
 检测波长 :254nm  
 流动相 :甲醇 (0.1%TFA) : 水 (0.1%TFA) =80:20  
 报告文件名 :RM24182  
 数据采集 :2024-8-19 10:06:08  
 数据处理 :2024-8-19 10:17:50

色谱图

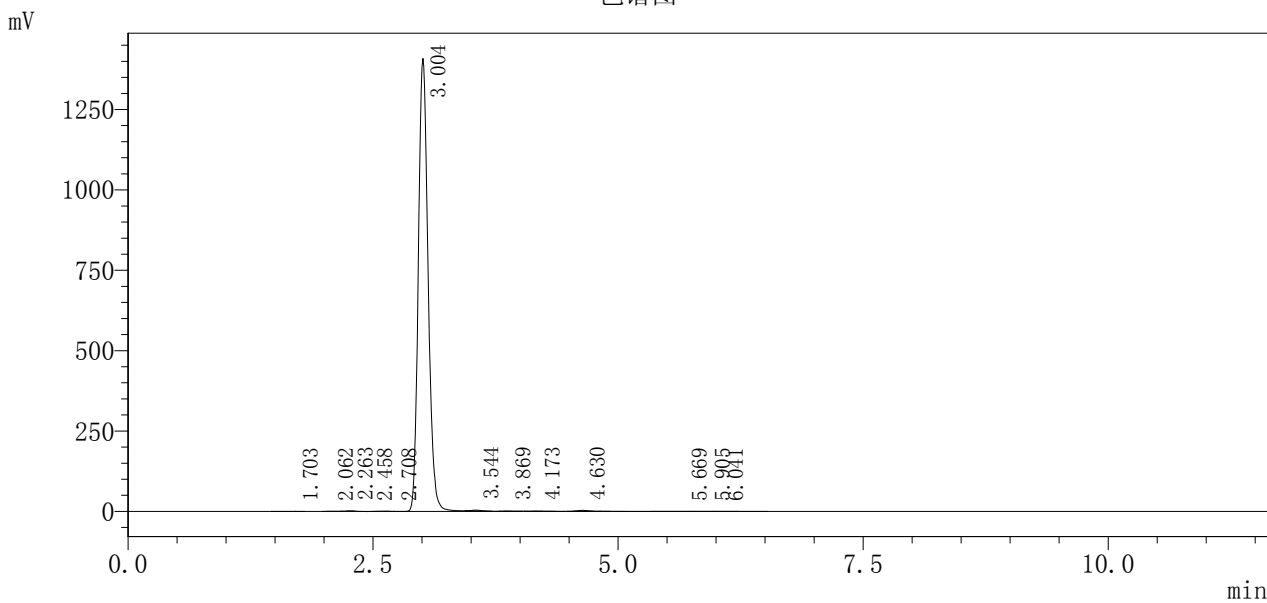

1 检测器 A 通道1 / 254nm

峰表

检测器 A Ch1 254nm

峰#	保留时间	面积	高度	面积 %
1	1.703	1800	228	0.018
2	2.062	2253	444	0.023
3	2.263	16913	2077	0.172
4	2.458	3148	394	0.032
5	2.708	1704	233	0.017
6	3.004	9752113	1409023	99.108
7	3.544	17957	2756	0.182
8	3.869	2170	329	0.022
9	4.173	5390	676	0.055
10	4.630	32602	3091	0.331
11	5.669	1252	88	0.013
12	5.905	1269	114	0.013
13	6.041	1271	129	0.013
总计		9839842	1419582	100.000