


HPLC Report

样品名称:	PC-7246201	采集者:	System
样品类型:	未知	采集时间:	2025/3/17 10:43:40 CST 15min
瓶号:	2	采集方法组:	通用方法 214nm 254nm
进样次数:	1	处理日期:	2025/3/17 11:58:18 CST 100
进样体积:	3.00ul	处理方法:	W2996 214.0nm 1.2
运行时间:	15.0 Minutes	通道名称:	W2996 PDA 214.0 纳米(于 1.2)
样品组名称:	121	处理通道注释:	1.2)

自动缩放色谱图

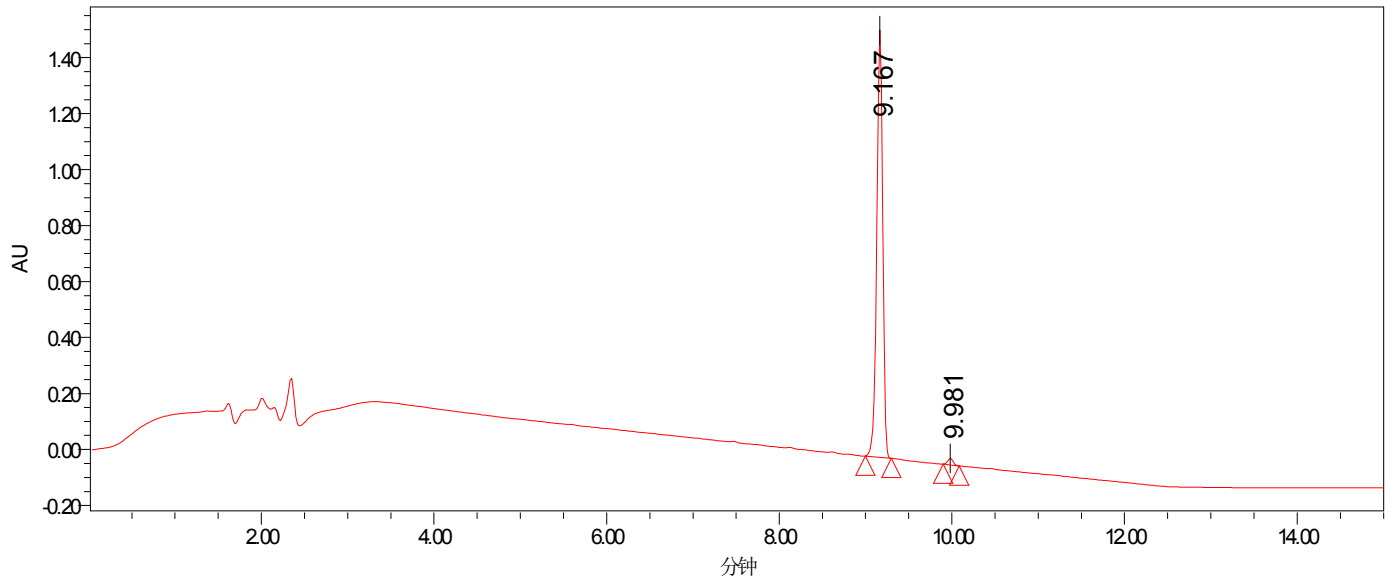

— 样品名称MU-404-T;样品瓶2;进样1;通道W2996 214.0nm 1.2;采集日期2024/3/11 10:43:40 CST

处理通道 W2996 PDA 214.0 纳米(于 1.2)

	处理通道	保留时间 (分钟)	面积	% 面积	峰高
1	W2996 PDA 214.0 纳米(于 1.2)	9.167	7285337	98.64	1500755
2	W2996 PDA 214.0 纳米(于 1.2)	9.981	100155	1.36	22596