


数据文件: HPLC-DC-SX29. dx
 序列名称: SingleSample 项目名称: ls1123
 样品名称: HPLC-DC-SX29 操作者: admin
 仪器: 1260 进样日期: 2024/6/27 12:14:18 (GMT +08:00)
 进样体积: 0.7 位置: PID4
 采集方法: 液相专用方法. amx 类型: 样品
 处理方法: ls1123处理方法 样品含量: 0.00
 手动修改: 无

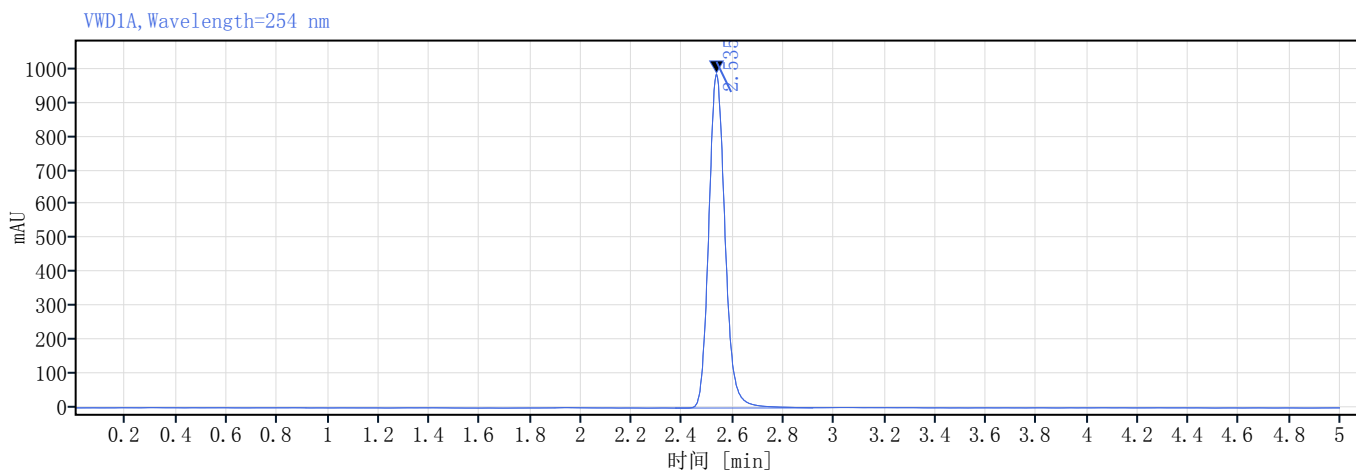

信号: VWD1A, Wavelength=254 nm

保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积	高度	峰面积%	名称
2.535	BV	0.54	4414.87	985.63	100.00	
		总和	4414.87			